National

保管用

保証書付

医療用具許可番号
25BZ0062

ナショナル エアーマッサージャー

エアーキュット EP1611

ふくらはぎ用

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
  特に「安全上のご注意」（2～5ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

（イメージ写真）

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は電源プラグを抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

● ふくらはぎ用アタッチメントの上下を逆に装着して使用しない。
事故や体調不良の原因になります。

● 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

（1）心臓に障害のある人
（2）ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
（3）悪性腫瘍のある人
（4）妊娠中や生理中の人
（5）かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
（6）骨の弱い人（骨粗しょう症など）
（7）安静を必要とする人
（8）熱の高い人（38℃以上）
（9）重度の血行障害のある人
（10）上記以外に特に身体に異常を感じているとき

守らないと事故や体調不良の原因になります。

● マッサージ以外の目的で使用しない。
事故やけがの原因になります。

● 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
発火や感電の原因になります。

⚠警告

禁止

- **電源コードや電源プラグがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **変圧器による使用はしない。**
  事故や感電の原因になります。
- **本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。**
  事故や感電の原因になります。

ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。

必ず守る

- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと発火や感電の原因になります。
- **動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。**
  そのまま使用すると発火や感電の原因になります。

分解禁止

- **絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。**
  発火や感電・けがの原因になります。

  修理はお買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

必ず守る

- **使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談のうえご使用ください。**
  守らないと事故や体調不良をおこす原因になります。
- **幼児やお子様、また自分で操作のできない人に使わせない。**
  守らないと事故やけがの原因になります。
- **マッサージは1回15分以内にする。**
  守らないと逆効果やけがの原因になります。
- **電源コードを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
  守らないと感電やショート・発火の原因になります。

禁止

- **ふくらはぎ以外には使用しない。**
  けがの原因になります。
- **電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを付着させない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **収納時にコードを本体に巻きつけない。**
  コードに負担がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

水場使用禁止

- **浴室などの湿気の多い場所で使わない。**
  感電や故障の原因になります。

電源プラグを抜く

- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと感電ややけどの原因になります。
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

もくじ

2 安全上のご注意

7 各部のなまえ

8 準備

- ふくらはぎ用アタッチメントの装着 ……8

10 使いかた

- 電源を入れてマッサージする ……10
- マッサージの内容について ……12

14 使用後は

- 使い終わったら ……14
- お手入れと保管 ……15

16 お知らせ

- Q&A ……16
- 別売品のご案内 ……16
- 故障かな？と思ったとき ……17
- 保証とアフターサービス ……18

各部のなまえ

本体

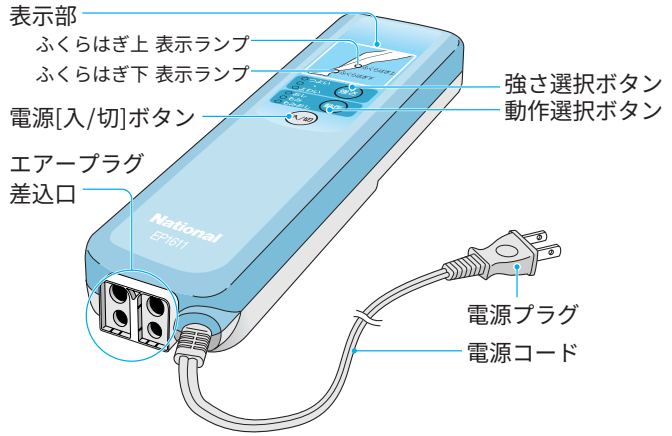

ふくらはぎ用アタッチメント（2個）※左右共通です

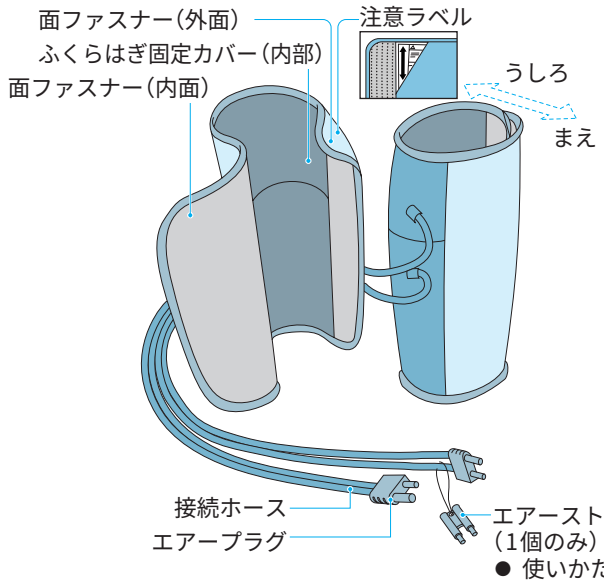

- 使いかた：P9参照

ふくらはぎ用アタッチメントの装着

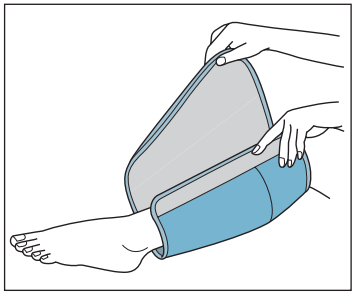

1 ふくらはぎに装着する

- 上下を合わせる。
  （注意ラベルの付いているほうが上側です）
- ふくらはぎ固定カバーをふくらはぎに当てる。

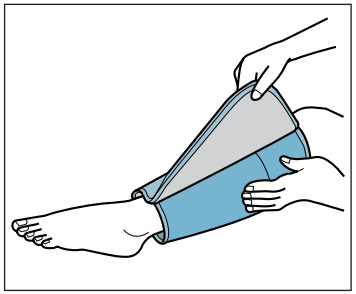

2 面ファスナーでしっかり固定する

- 面ファスナーがはずれないように手でしっかり押さえて固定する。
- 巻きつけがゆるいと動作しない場合があります。（P17参照）
- ストッキングをはいている場合は面ファスナー（外面）に付かないように気をつけてください。

アタッチメントをふくらはぎに装着せずに動作させない。
アタッチメントに過度の圧力がかかり、空気もれをおこす原因になります。

⚠警告

- **アタッチメントの上下を逆に装着して使用しない。**
  事故や体調不良の原因になります。
- **医師の治療を受けている人や、心臓障害のある人、ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人、悪性腫瘍のある人、妊娠中や生理中の人、かつて治療を受けたところや疾患部へ使用する人、骨の弱い人（骨粗しょう症など）、安静を必要とする人、熱の高い人（38℃以上）、重度の血行障害のある人、その他特に身体に異常を感じている人は、医師と相談のうえ使用する。**
  事故や体調不良の原因になります。
- **マッサージ以外の目的で使用しない。**
  事故やけがの原因になります。

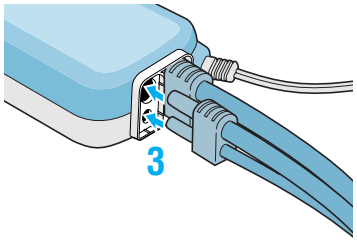

3 エアープラグを本体に差し込む

- 穴の大きさに合わせて縦にカチッと音がするまで差し込む。
- ホースを踏んだり、上に重い物を載せたりしない。

●片脚のみ使用の場合（片脚のみのご使用もできます）

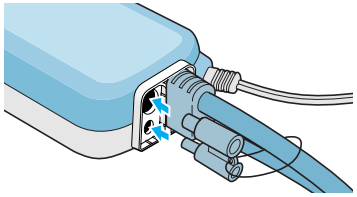

- エアーストッパーの付いたアタッチメントを使用する
- エアープラグを本体に差し込んだ後、残りのエアープラグ差込口にエアーストッパーを差し込む（左右どちらでもかまいません）
- 2人で片脚ずつ使用しない。
- もみおし、もみ動作でご使用の場合、ステップ加圧の回数が少なくなる場合があります。

（P12参照）

⚠警告

- **本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。**
  事故や感電の原因になります。

⚠注意

- **ふくらはぎ以外は使用しない。**
  けがの原因になります。
- **幼児やお子様、また自分で操作できない人に使わせない。**
  守らないと事故やけがの原因になります。
- **浴室など湿気の多い場所で使わない。**
  感電や故障の原因になります。

電源を入れてマッサージする



1 電源プラグを差し込む

ワンポイントアドバイス
ここちよくご使用するために、ひざを少し曲げふくらはぎの筋肉がゆるんだ状態でご使用することをおすすめします。

2 電源［入/切］ボタンを押し電源を入れる

●電源を入れてから約15分で自動的に電源が切れます。（15分タイマー）

肉ばなれのしやすい人や皮膚の弱い人は、始めは使用時間を短くしてください。

アタッチメントをこたつの中やファンヒータの前など表面温度の上がる場所で使用しない。
アタッチメントが加熱され素材変形、強度低下をおこし空気もれをおこす原因になります。

⚠警告

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。
- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと発火や感電の原因になります。
- **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。**
  発火や感電の原因になります。
- **電源コードや電源プラグがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **変圧器による使用はしない。**
  事故や感電の原因になります。

3 動作選択ボタンを押し動作を選ぶ

（P12参照）

●選んだ動作のランプが点滅する。

4 強さ選択ボタンを押し強さを選ぶ

●選んだ強さのランプが点滅する。

●始めは「よわい」で使い、慣れてから強さを調整する。
（マッサージの途中で替えられます）

5 マッサージが終わったら電源を切る

ソックスやズボンの上からご使用ください。足に使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますので、お出かけ前のご使用にはご注意ください。

⚠警告

- **動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。**
  そのまま使用すると発火や感電の原因になります。

⚠注意

- **使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談の上ご使用ください。**
  守らないと、事故や体調不良をおこす原因になります。
- **マッサージは1回15分以内にする。**
  守らないと逆効果やけがの原因になります。

マッサージの内容について

動作について

	加圧表示と加圧イメージ	加圧方法	特徴
もみおし	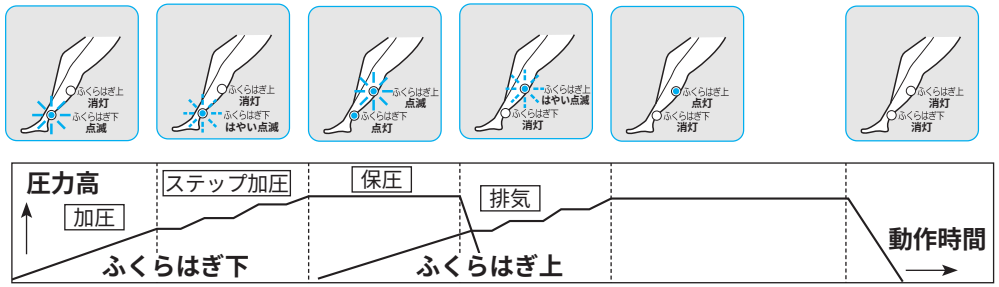	●所定圧力まで加圧した後、階段状に細かく加圧と保圧をくり返し、(ステップ加圧）その後、一定時間保圧を行う。 ●ふくらはぎ下からふくらはぎ上へと順送りで加圧が行われる。	●リズミカルで心地よい刺激とじっくりとした保圧の組合せにより、効果的なマッサージができる。
もみ	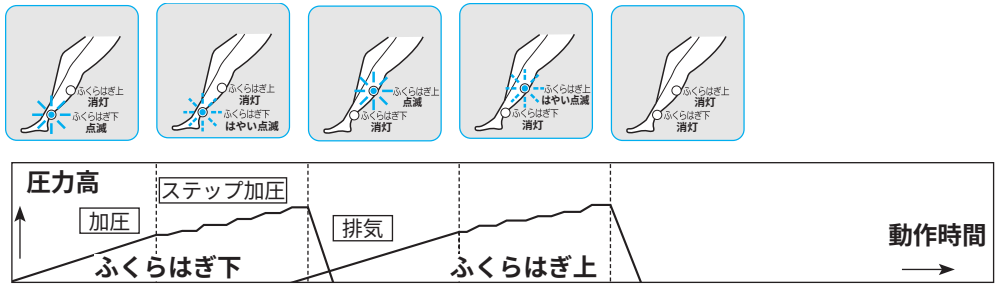	●所定圧力まで加圧した後、階段状に細かく数多く加圧と保圧をくり返す。（ステップ加圧） ●ふくらはぎ下からふくらはぎ上へと順送りで加圧が行われる。	●刺激の強さをリズミカルに変化させているので、心地よい刺激が得やすい。 ●はじめてお使いの方や比較的疲れが軽い方におすすめ。
おし	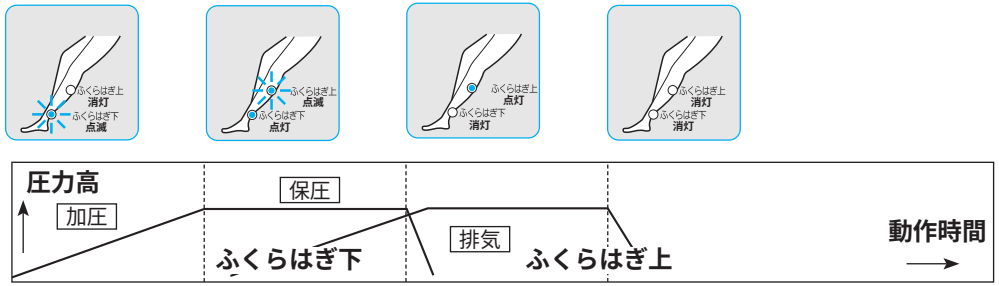	●所定圧力まで加圧した後、一定時間保圧を行う。 ●ふくらはぎ下からふくらはぎ上へと順送りで加圧が行われる。	●充分な保圧をじっくり行うので、とどこおった血行を効果的に促進しやすい。 ●慢性的にふくらはぎのむくみ、疲れが気になる方におすすめ。

使い終わったら

必ず電源「切」の状態で行ってください。



1 電源プラグを抜く



2 本体からエアープラグを抜く

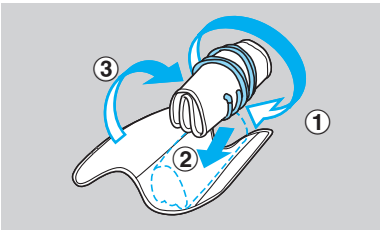

3 アタッチメントを重ねる

①アタッチメントを丸め、ホースで巻く。
②丸めたアタッチメントをもう一方のアタッチメントを重ねる。
③包み込むように丸め、ホースを巻く。
ホースが折り曲がらないように注意する。
ホースははずさない。

4 電源コードはコードバンドで結束する

●本体に巻きつけない。

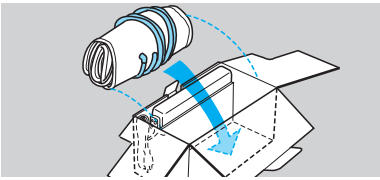

5 箱に収納する

●箱は収納時にご利用ください。

⚠注意

- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- **電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
  守らないと感電やショート・発火の原因になります。

お手入れと保管

必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。

■お手入れは…

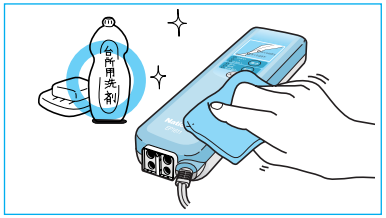

本体・アタッチメントの汚れは、石ケン液を含ませた布でふく

- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。
- エアープラグ差込口に異物を入れない。

■保管は…

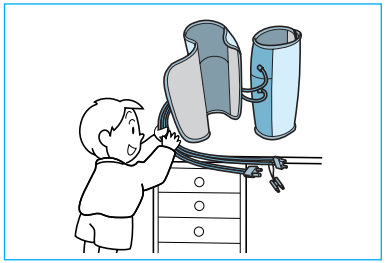

小さな子供の手の届く所に置かない

- 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしない。
- 温度・湿度の高い所や直射日光のあたる所に置かない。
- ふくらはぎ用アタッチメントに、針やピン等を刺さない、また鋭利なものをあてない。
- ふくらはぎ用アタッチメントの表面にものを置いた状態で保管しない。
  足用アタッチメントの表面に跡がついたり、色移りするおそれがあります。

（ふくらはぎ用アタッチメント）を紛失されたとき

最寄りの販売店にてお買い求めください。
（ご注文品番）EP0163（2個入り）

⚠注意

- **電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを付着させない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと感電ややけどの原因になります。
- **収納時にコードを本体に巻きつけない。**
  コードに負担がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

Q&A

エアーマッサージについてQ&Aでお答えします。

Q1 「ダブルエアーもみ」って何ですか？

A1：

●空気ならではのやさしい感触で、ふくらはぎの下→上の順に加圧・排気をくり返す方式です。

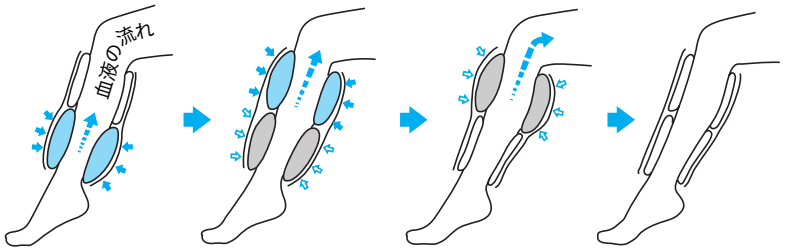

ふくらはぎ下を加圧 → ふくらはぎ下を保圧して ふくらはぎ上を加圧 → ふくらはぎ下を排気しながら、ふくらはぎ上を保圧 → 排気

（イメージ図）

Q2 なぜ「使ってはいけないとき」があるの？

A2：

●発熱時：特に原因不明時は重大な病気かもしれません。

●生理中：周期を乱したり、体調を崩す原因になります。

●妊娠中、産後：ホルモンのバランスが崩れています。

●高血圧、重度の血行障害の人：血管に大きな負担となります。

以上のような場合は必ず医師と相談のうえ、ご使用ください。

■別売品のご案内

下記のアタッチメントも取り揃えております。

＜足用アタッチメント＞

品番　EP0162（2個入り）

●むくみや冷たくなった足の疲れ等の血行促進に効果的です。

●足裏突起マット、足首指圧シート（各2個）付。（着脱可能）

※ふくらはぎ用との同時使用はしないでください。

故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします。

こんなとき	原因と処置
●動かない ●表示ランプが点灯しない	●電源プラグが抜けていないか確認する。▶（P10参照）
●「つよい」にしても圧力が弱い	●ふくらはぎ用アタッチメントがしっかり固定されているか確認する。▶（P8参照） ●接続ホースに物を載せていないか確認する。▶（P9参照）
●強さ表示ランプ 動作表示ランプがすべて点滅	●エアープラグが抜けていないか確認する。▶（P9参照）

上記の「原因と処置」での点検後、なお異常がある場合は使用を中止し、事故防止のため、ただちに電源プラグを抜き必ず販売店に修理を依頼してください。

⚠警告

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理しない。
発火や感電・けがの原因になります。

■定格・仕様

販売名		エアーマッサージャー　エアーキュット　EP1611		
使用電源		電源AC100V　50—60Hz	消費電力	7W
類別		器具器械（77）　バイブレーター	一般的名称	家庭用エアマッサージ器
医療用具許可番号		25BZ0062		
エアースピード		15～40秒／1サイクル（片足使用時は10～20秒／1サイクル）		
圧力		よわい：約130hPa、ふつう：約195hPa、つよい：約260hPa		
安全装置		「入／切」ボタン切り後3秒で67hPa以下に減圧		
タイマー		約15分		
寸法	本体	たて235×よこ64×高さ40（mm）		
	ふくらはぎ用アタッチメント	たて300×よこ125×高さ95（mm）／ホース長さ100cm		
質量	本体	約425g		
	ふくらはぎ用アタッチメント	約340g（1個あたり）		
定格時間		連続		
アタッチメント対応寸法		ふくらはぎ周長　約27～48cm		
製造業者		日光精器株式会社 大阪府枚方市岡南町6番37号		

愛情点検　**長年ご使用のマッサージャーの点検をぜひ！**

このようなことはありませんか？	お願い
・コードやプラグが異常に熱い。 ・作動中に異常な音、振動がする。 ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナルエアーマッサージャーの補修用性能部品は製造打切り後6年保有しております。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の17頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで保証書をそえて製品をご持参ください。
  保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401㊫ 名古屋 ☎052-551-7900㊫
東京 ☎03-5392-7190㊫ 福岡 ☎092-622-0531㊫

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（バナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
   なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 **松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部**
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

2003年2月24日作成（新様式第1版）

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル エアーマッサージャー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EP1611
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　）　ー
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　ー

松下電器産業株式会社

製造元 **松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部**

〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。　Y.No6

キリトリ線